



Servizi offerti

Software Control and Monitoring

Il software Control and Monitoring è stato pensato per la gestione di camere termo climatiche in collegamento con il controllore a bordo camera .

Il software può gestire tutte le funzioni presenti ed attivate sullo strumento installato a bordo apparecchiatura

Funzioni base

Controllo funzionamento in modalità MANUALE

Controllo funzionamento in modalità PROGRAMMA

Editazione PROGRAMMI

Archiviazione programmi su strumento o su P.C.

Registrazione grafica (se attivata) di tutti i dati visibili sullo strumento

Registrazione eventi

Registrazione allarmi

Archiviazione - visualizzazione - stampa - esportazione dei dati registrati

strumenti collegabili

regolatore/programmatore Eurotherm 2604

regolatore/programmatore Watlow (a richiesta)

plc con protocollo ModBus (a richiesta)

configurazione minima Personal Computer

Sistema Operativo utilizzabile: Microsoft Windows 2000 / XP®

Processore: Pentium III o equivalente o più recente

Memoria minima richiesta: 256 MBytes


Spazio minimo su disco richiesto: 20 Gbytes

collegamenti



RS 232

RS 422

RS 485



Il servizio di assistenza tecnica viene fornito in collaborazione con la Emmevieffe s.r.l.

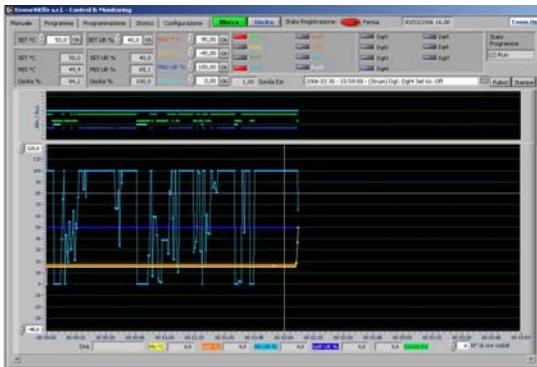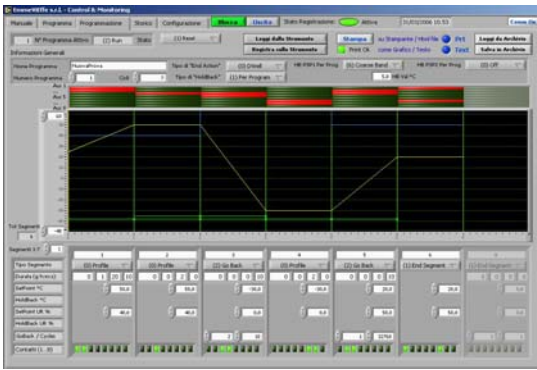

Mzmg	Data Ora	TReal	TSPort	UR Real	UR SP	TMin	UR Max	UR Min	Aux1	Aux2	Aux3	Aux4	Aux5	Aux6	Aux7	Aux8	Sonda Est	S Ed?
1	2009-03-31 09:25:33	0.0	0.0	0.0	0.0	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0.0	0h
2	2009-03-31 09:26:19	74.8	75.0	100.0	20.0	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	1.0	0h
3	2009-03-31 09:26:39	74.8	75.0	100.0	20.0	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	1.0	0h
4	2009-03-31 09:26:59	74.8	75.0	100.0	20.0	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	1.0	0h
5	2009-03-31 09:27:19	74.8	75.0	100.0	20.0	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	1.0	0h
6	2009-03-31 09:27:39	74.1	75.0	40.7	20.0	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	1.0	0h
7	2009-03-31 09:27:59	74.1	75.0	40.7	20.0	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	1.0	0h
8	2009-03-31 09:28:19	72.3	75.0	34.7	20.0	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	1.0	0h
9	2009-03-31 09:28:39	72.3	75.0	34.7	20.0	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	1.0	0h
10	2009-03-31 09:28:59	72.1	75.0	28.7	20.0	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	1.0	0h
11	2009-03-31 09:29:19	72.1	75.0	28.7	20.0	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	1.0	0h
12	2009-03-31 09:29:39	72.1	75.0	19.3	20.0	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	1.0	0h
13	2009-03-31 09:29:59	72.1	75.0	19.3	20.0	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	1.0	0h
14	2009-03-31 09:30:19	72.1	75.0	23.9	20.0	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	1.0	0h
15	2009-03-31 09:30:39	72.1	75.0	28.5	20.0	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	1.0	0h
16	2009-03-31 09:30:59	85.9	75.0	44.1	20.0	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	1.0	0h
17	2009-03-31 09:31:19	85.9	75.0	44.1	20.0	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	1.0	0h
18	2009-03-31 09:31:39	85.9	75.0	28.8	20.0	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	1.0	0h
19	2009-03-31 09:31:59	85.9	75.0	28.8	20.0	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	1.0	0h
20	2009-03-31 09:32:19	85.8	75.0	100.0	20.0	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	1.0	0h
21	2009-03-31 09:32:39	85.8	75.0	100.0	20.0	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	1.0	0h
22	2009-03-31 09:32:59	85.8	75.0	100.0	20.0	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	1.0	0h
23	2009-03-31 09:33:19	45.8	74.0	100.0	10.0	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	1.0	0h

Vendita ed assistenza tecnica di camere
 per la simulazione ambientale, congelatori -85°C
 impianti frigoriferi settore ospedaliero - industriale